



Serien-Nr./Serial-No.: 1A03MXDONJM





FLM / BLM (FFG-T / FFG-BT) Calibration Certificate

Ser.-No.: / Ger.-Nr.: 38206
Measured length: / Verfahrenweg: 955 mm
Increment: / Schrittweite: 4 mm
Test result: / Gesamtergebnis: OK

Order No.: / Auftrags-Nr.: 2031981
Probe type: / Sondentyp: Ex XTS B NT
Probe length: / Sondenlänge: 1075 mm
Production date: / Produktions Datum: 06.12.2024

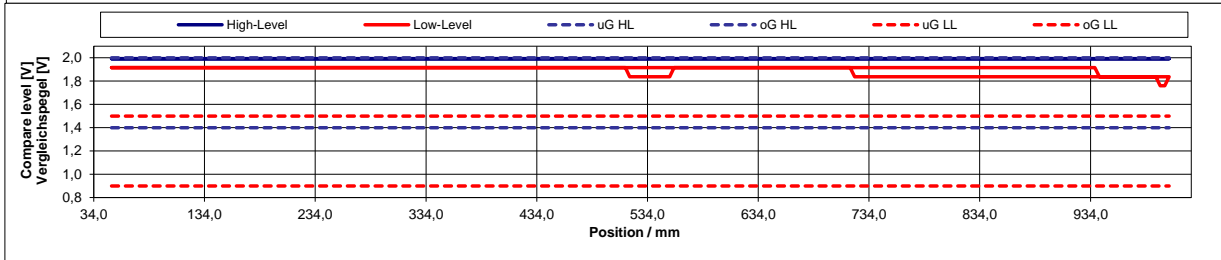

Regression line: 0,30585 Gradient: 1,0001 => Failure: 0,09605 mm/m
Regressionsgerade: 0,30585 Steigung: 1,0001 => Fehler: 0,09605 mm/m Axis intercept: -0,0294 mm



Variance T: 0,07 °C Average error: -0,65 °C Adjustment: 0,32 m/s
Varianz T: 0,07 °C Mittlerer Meßfehler: -0,65 °C Korrektur: 0,32 m/s

