

Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1
Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1

Page
Seite 1 / 2

Customer:
Kunde: **Engemann u. Co Internationale Spedition GmbH**
Otto-Hahn-Str. 29
DE 40721 Hilden

Certificate No.
Zeugnis-Nr. **01404980**

Date
Datum **04.12.2024**

Customer order number
Kundenbestellnummer **DELTA-WIKA-2024-PO-200**

Customer Part. No.
Kunden Artikel-Nr.

order date
Bestelldatum **03.10.2024**

Order No. / Item
Auftrags-Nr. / Pos. **S110232513/1**

Part No.
Artikel-Nr. **14728736**

Model
Typ **233.30**

Scale range
Anzeigebereich **-1 ... 24 barg rel.**

Serial number
Seriennummer **8976ESEM**

Class
Klasse **1,00 %**

Tag No.
Messstellen-Nr. **PG-RU0001B-01**


Reference
Referenzgerät
CPG2500 0,008% IS33 -1 ... 69 bar rel.

Calibration No.
Kalibriernummer
C01107644130 DKD 24-05

Result
Ergebnis

Temperature
Temperatur **20 °C +/- 5 K**

Test Item Prüfling barg	Standard Referenz barg		Meanvalue Mittelwert barg	rel. Deviation rel. Abweichung barg	Deviation Abweichung %	Hysteresis Hysterese %
	↑	↓				
-0,900	-0,925	-0,898	-0,911	0,011	0,05	0,11
5,000	5,012	4,931	4,972	0,028	0,11	-0,32
11,500	11,588	11,450	11,519	-0,019	-0,08	-0,55
20,000	19,856	19,959	19,908	0,092	0,37	0,41
24,000	23,878	23,878	23,878	0,122	0,49	0,00

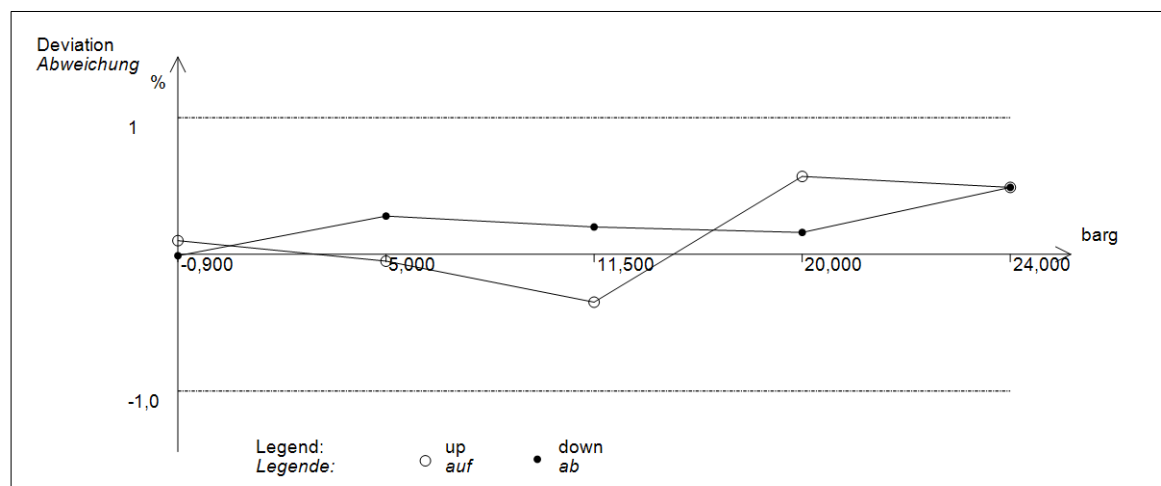

Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1
Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1

Page
Seite 2 / 2

Customer:
Kunde: **Engemann u. Co Internationale Spedition GmbH**
Otto-Hahn-Str. 29
DE 40721 Hilden

Certificate No.
Zeugnis-Nr. **01404980**

Date
Datum **04.12.2024**

Object keeps the specification.


Der Kalibriergegenstand hält die Fehlergrenzen nach Herstellerangaben ein.

Calibration was carried out according to the following norm:

Die Kalibrierung erfolgte auf der Grundlage der folgenden Norm:

DIN EN 837-1

Remarks / Bemerkung:

Inspection Representative
Abnahmebeauftragter **(GA) Paweł Golasinski** 

Examiner
Prüfer **A.Zakowiecka**

The inspection certificate was created electronically and is hereby validated by named inspection representative. This document is valid without signature.

Dieses Abnahmeprüfzeugnis wurde elektronisch erstellt und wird hiermit vom genannten Abnahmebeauftragten bestätigt. Das Dokument gilt ohne Unterschrift.